


# ホットプローブホルダ No.345A 取扱説明書

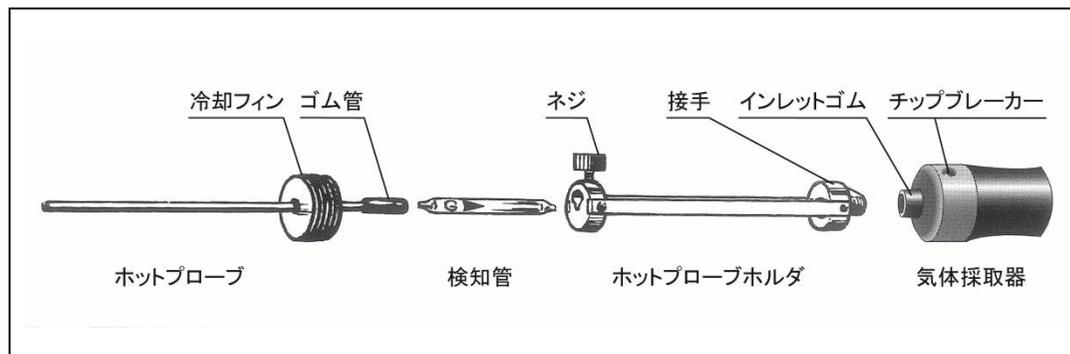

- ① 気体採取器の入口ナットを取り外し、代わりに接手によってホットプローブホルダを取り付けてください。
- ② 検知管の両端をチップブレーカーで折り取った後、矢印▶が気体採取器に向くように検知管をホットプローブのゴム管にセットしてください。
- ③ ホットプローブホルダのネジを十分開いておき、ホットプローブにセットされた検知管を穴に通し、さらにインレットゴムに差し込んでください。
- ④ ネジを締め込んでホットプローブを固定してください。

注) 使用に際しては、気体採取器、検知管及びホットプローブの取扱説明書を読んでください。

※ ホットプローブホルダは二連管検知管(2本接続して使用する検知管)および酸素検知管 31B には使用できません。

## ■保証とアフタサービス

●万一、品質に不都合な点がありましたら、弊社にお問い合わせください。

●ガス測定、品質に関する質問をお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先: 株式会社 ガステック 営業本部  
〒252-1195 神奈川県 綾瀬市 深谷中八丁目 8 番 6 号

TEL: 0467(79)3911 FAX: 0467(79)3979

ホームページアドレス: <https://www.gastec.co.jp/>